GMT MEDICAL | 德迈特医疗

活检针领导者
The Leading Biopsy Company

MegaCore2

复用型穿刺活检枪及一次性活检针

产品特点

- 独家国产复用型穿刺活检枪，品质卓越
- 配合一次性活检针使用，杜绝交叉感染，穿刺安全有效
- 弹簧力度大，极速切割，取样完整饱满
- 取样长度12&19mm可选，满足不同取样需求

主要临床应用部位：肝脏、肾脏、乳腺、前列腺、肺脏等

操作方法

1 STEP



① 持枪

枪体平放于手掌，手指置于上弦键

2 STEP

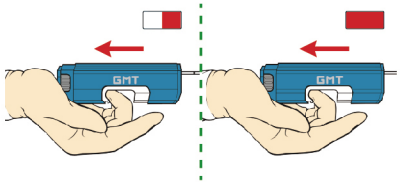

② 上弦

将白色的上弦键向后拉动两次，使活检枪处于待击发状态，状态显示由白色转为全红色

3 STEP



③ 选择穿刺深度

顺或逆时针拨动枪体尾端左上方的旋钮，选择穿刺深度，15&22mm可选，对应取样长度12&19mm

4 STEP



④ 安装活检针

打开枪盖，选取适合规格一次性活检针安装于枪体卡槽内，取下固定手柄，完全扣好枪盖

5 STEP



⑤ 穿刺

在影像学引导下，直接穿刺或通过同轴定位针穿刺，使针尖到达取样组织边缘

6 STEP



⑥ 打开保险

将枪体末端下方的保险杆从水平位的“S”（锁定状态）逆时针拨动到垂直位的“F”（可击发状态）

7 STEP

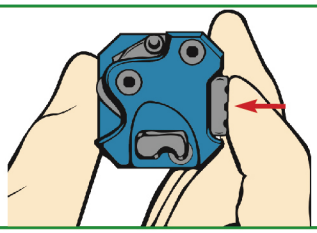

⑦ 击发

压下枪体尾端侧面的击发键，击发活检枪

8 STEP

⑧ 获取样本

向后拉动上弦键一次，获取组织条样本

MegaCore2 复用型穿刺活检枪

1. 穿刺深度调节旋钮
   15&22mm可选，对应取样长度
   12&19mm，满足不同取样需求

2. 上弦确认可视窗口
   便于观察操作状态

3. 活检针针体刻度标识
   保证患者安全
   便于掌握穿刺深度

4. 击发保险装置
   上弦后自动锁定状态，杜绝误击发

5. 板机式上弦键
   使用轻巧舒适，可实现单手操作

注意事项

清 洗

请使用中性洗涤剂溶于温水调配清洁液清洗，清洗后使用清水再次充分清洗，待枪体内外彻底干燥后，擦拭医用润滑油润滑（一次性活检针安装滑块请勿润滑）

禁止使用含戊二醛、浓双氯苯双胍己烷葡萄糖酸盐的杀菌溶液或其它含乙醇的试剂清洗

灭 菌

请使用压力蒸汽灭菌法或环氧乙烷灭菌法灭菌

禁止使用射线照射灭菌法灭菌

* 本手册内容仅供内部教学使用，最终解释权归德迈特医疗所有

订货信息(国产复用型穿刺活检枪)

订货编号	注册证名称及型号
B-T271522	活检枪(MegaCore2)

订货信息(国产一次性活检针)

规格(单位:G)	活检针规格	针管长度
14G	B-T101413	130mm
	B-T101416	160mm
16G	B-T101613	130mm
	B-T101616	160mm
	B-T101620	200mm
18G	B-T101813	130mm
	B-T101816	160mm
	B-T101820	200mm
注册证名称及型号	一次性穿刺活检针(BN-MCR-1/MC-MGN)	

订货信息(进口一次性活检针)

规格(单位:G)	活检针型号	针管长度
14G	MC1413	130mm
	MC1416	160mm
16G	MC1613	130mm
	MC1616	160mm
	MC1620	200mm
18G	MC1813	130mm
	MC1816	160mm
	MC1820	200mm
注册证名称及型号	穿刺活检针(MC xx/yy)	

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Developmennt Co.,Ltd
北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦A座610室
010-84195180
www.germanmedtech.com

关注德迈特医疗